PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	250.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	250.000	DEGF	FDEP	2876.00	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

CP 28.2 FILE 95 26-JAN-86 09:21

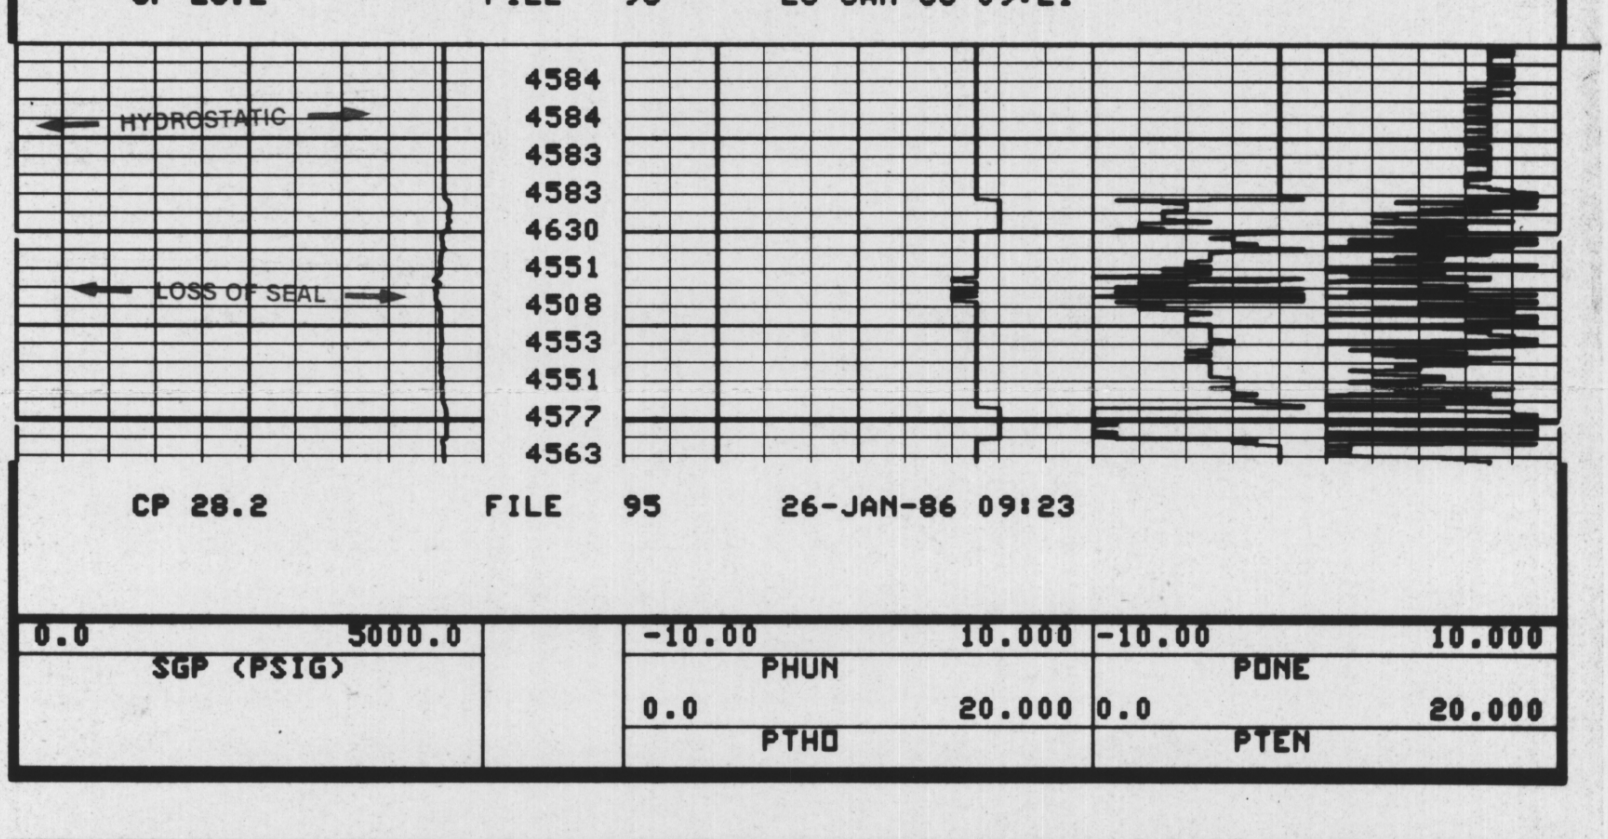

CP 28.2 FILE 95 26-JAN-86 09:23

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	251.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	251.000	DEGF	FDEP	2876.95	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

CP 28.2 FILE 96 26-JAN-86 09:27

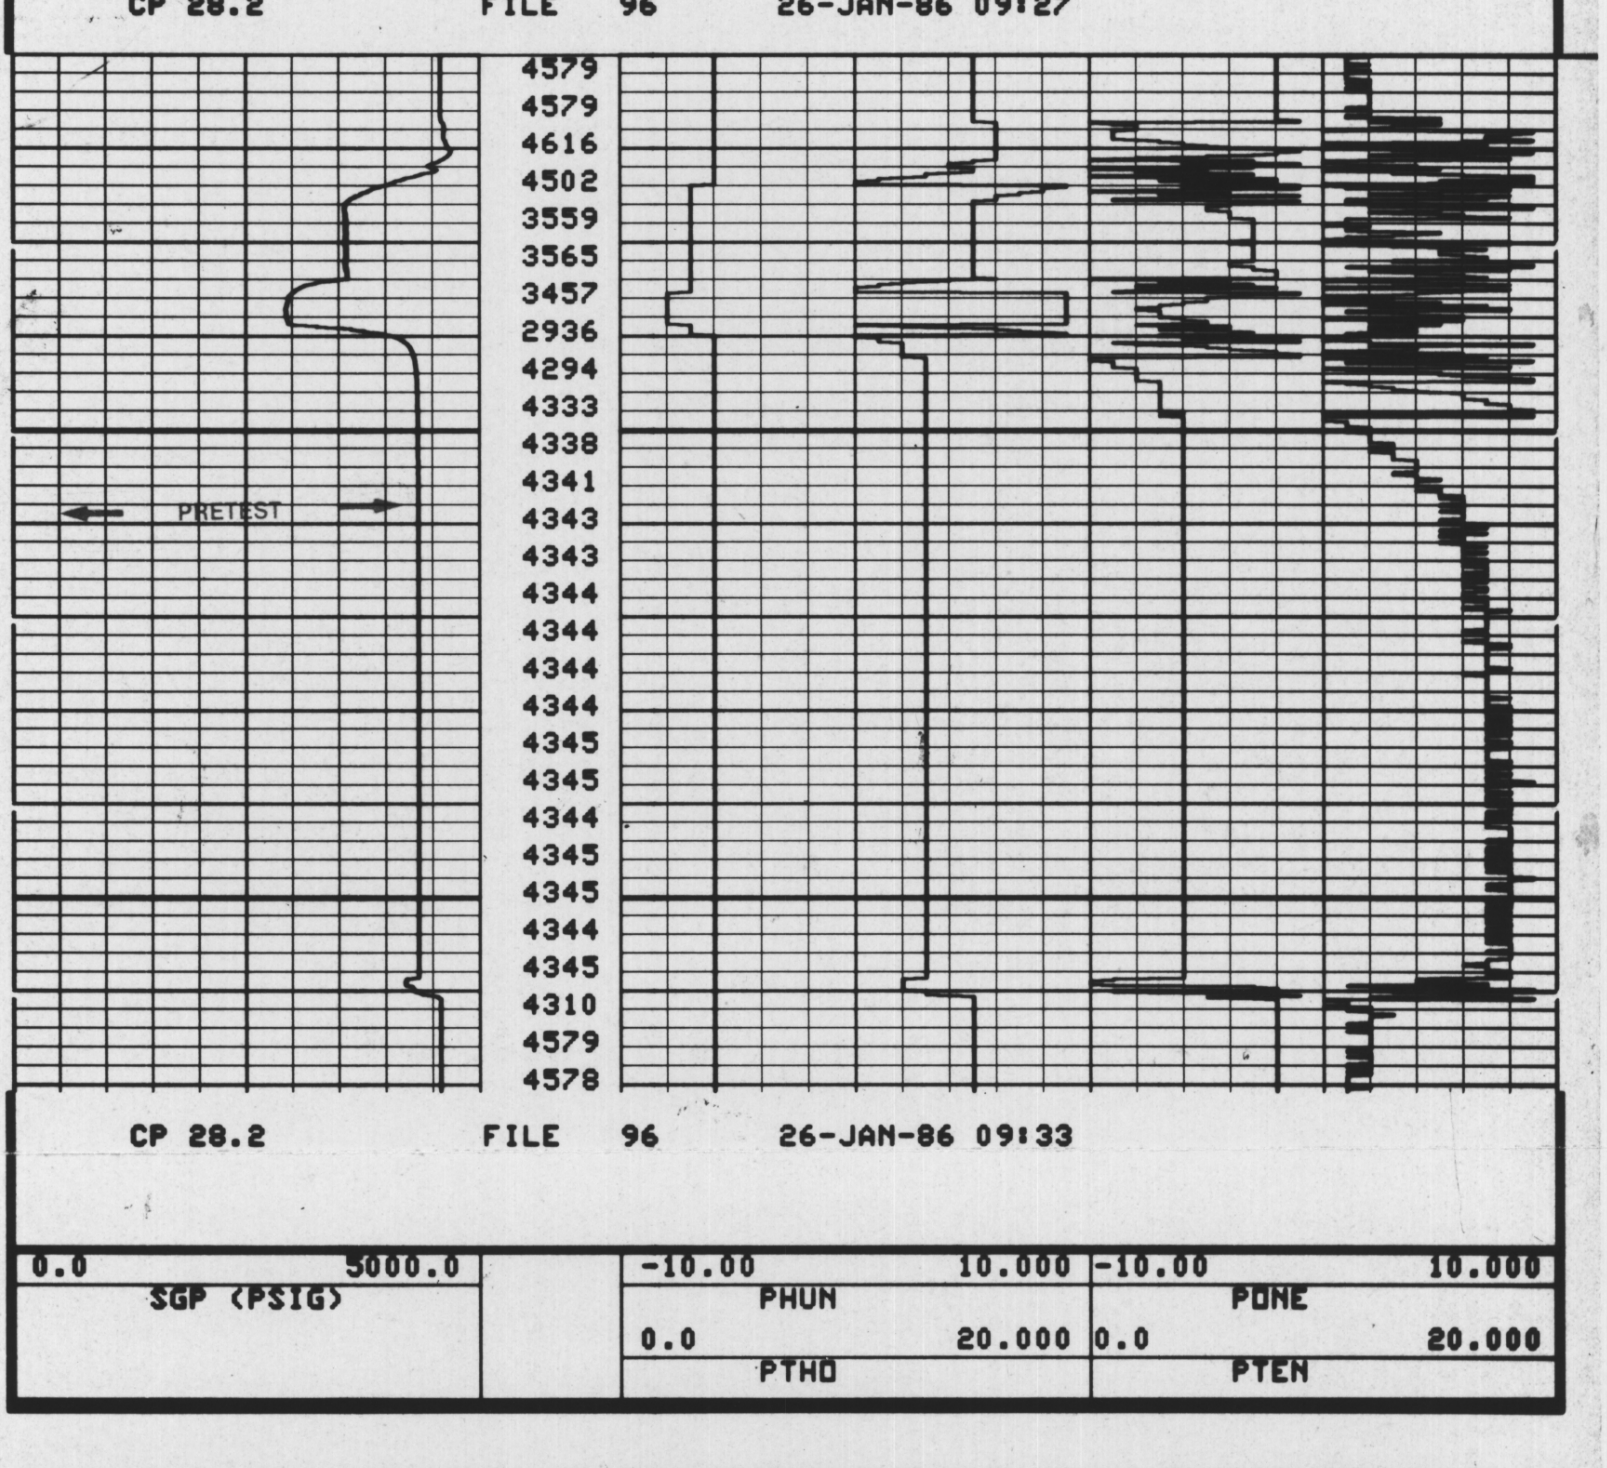

CP 28.2 FILE 96 26-JAN-86 09:33

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	251.500	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	251.500	DEGF	FDEP	2878.99	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

CP 28.2 FILE 97 26-JAN-86 09:36

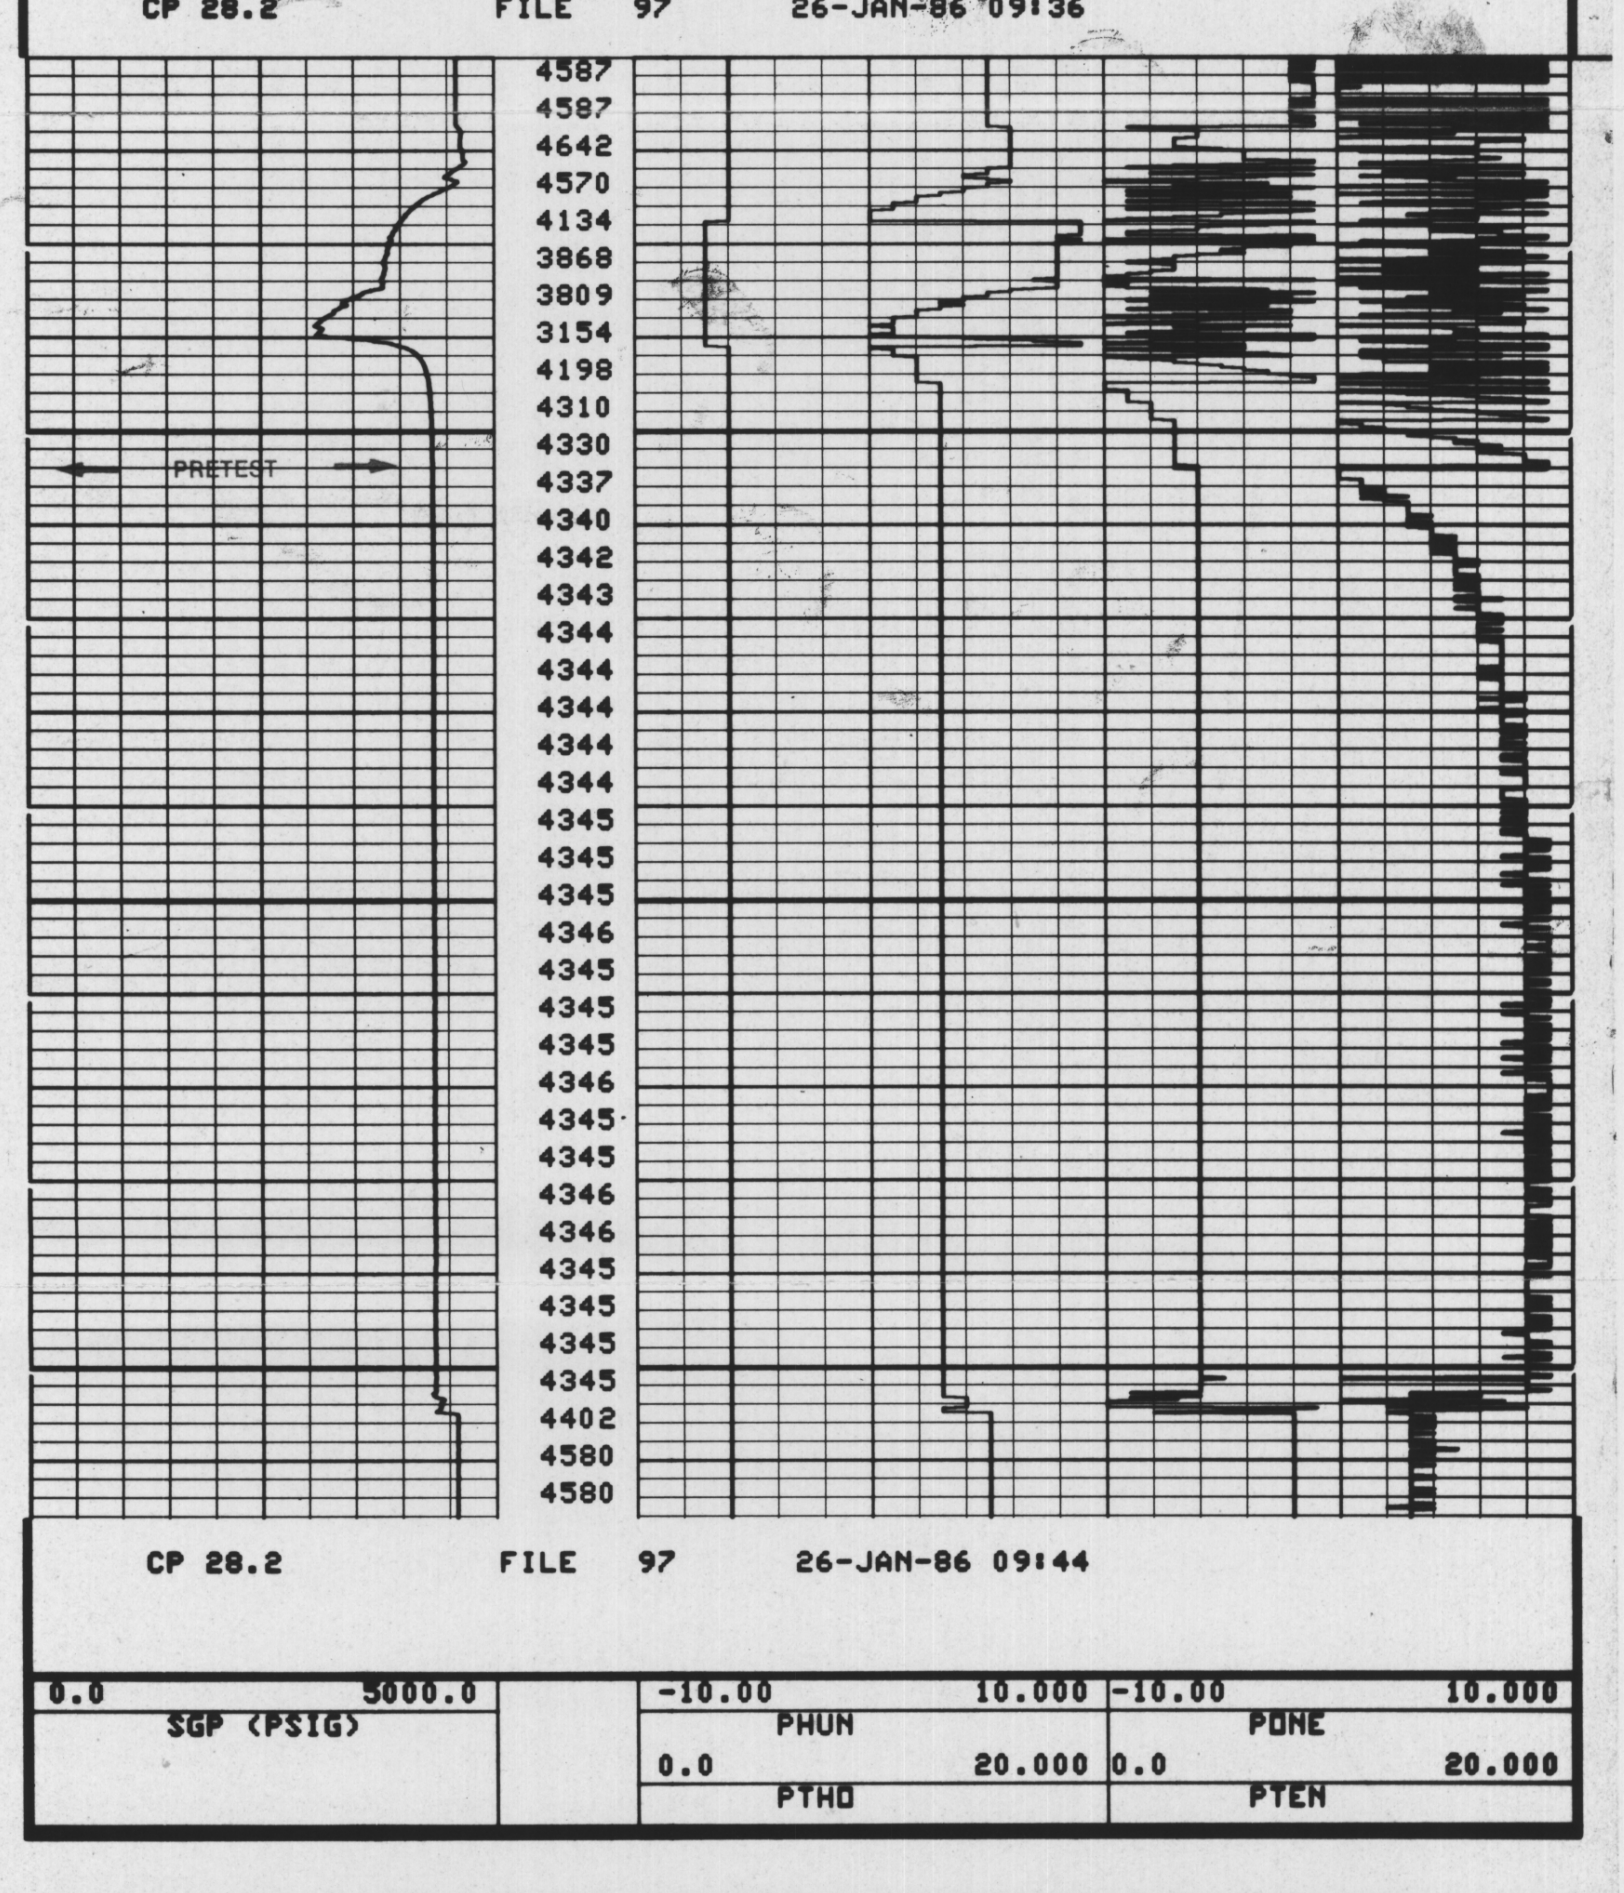

CP 28.2 FILE 97 26-JAN-86 09:44

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	253.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	253.000	DEGF	FDEP	2881.00	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

CP 28.2 FILE 98 26-JAN-86 09:47

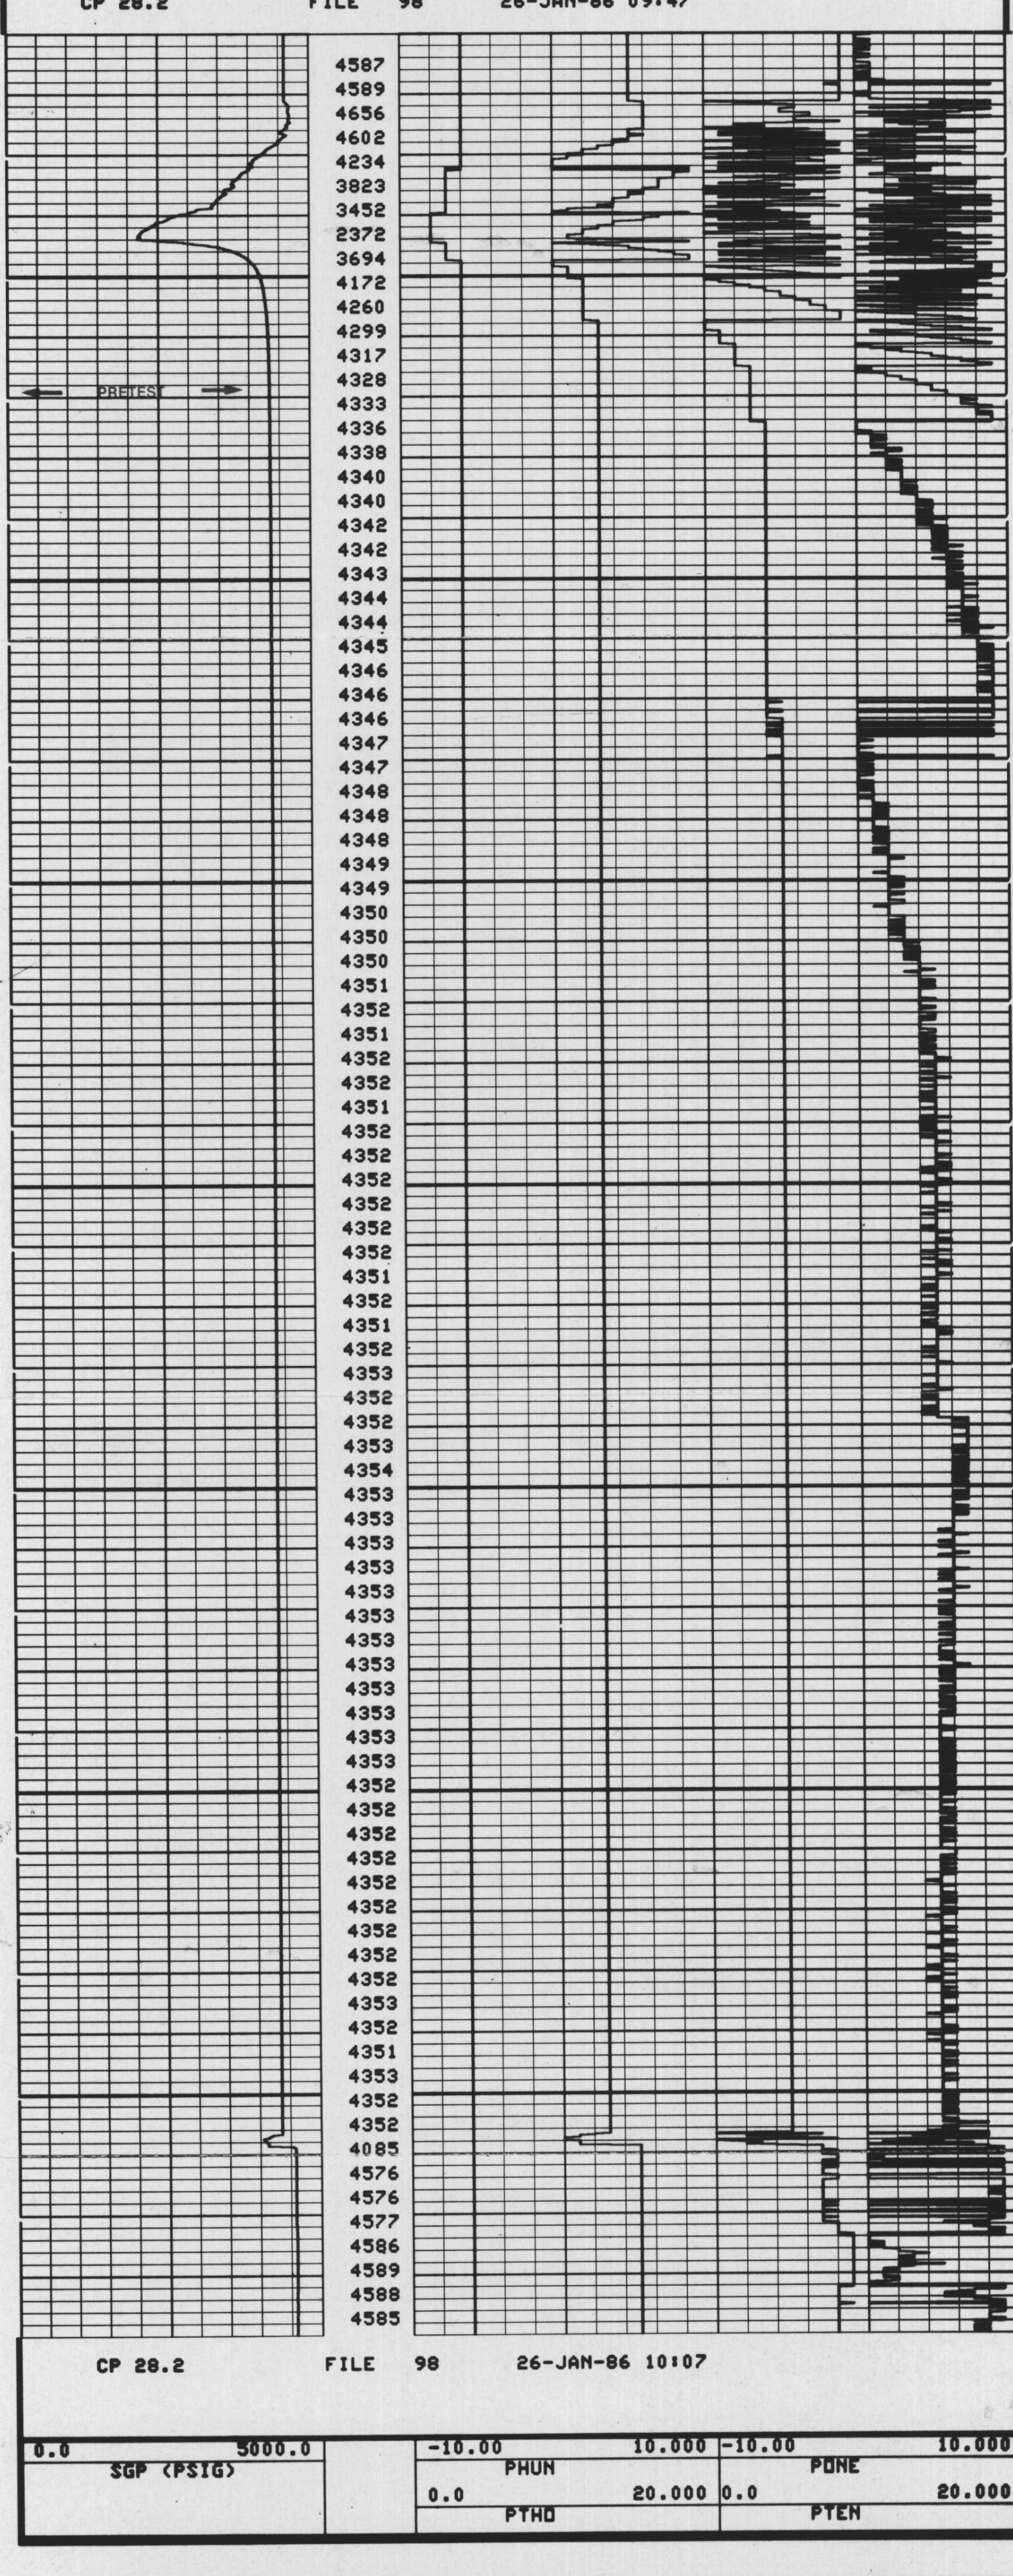

CP 28.2 FILE 98 26-JAN-86 10:07

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	253.500	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	253.500	DEGF	FDEP	2882.98	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

CP 28.2 FILE 99 26-JAN-86 10:10

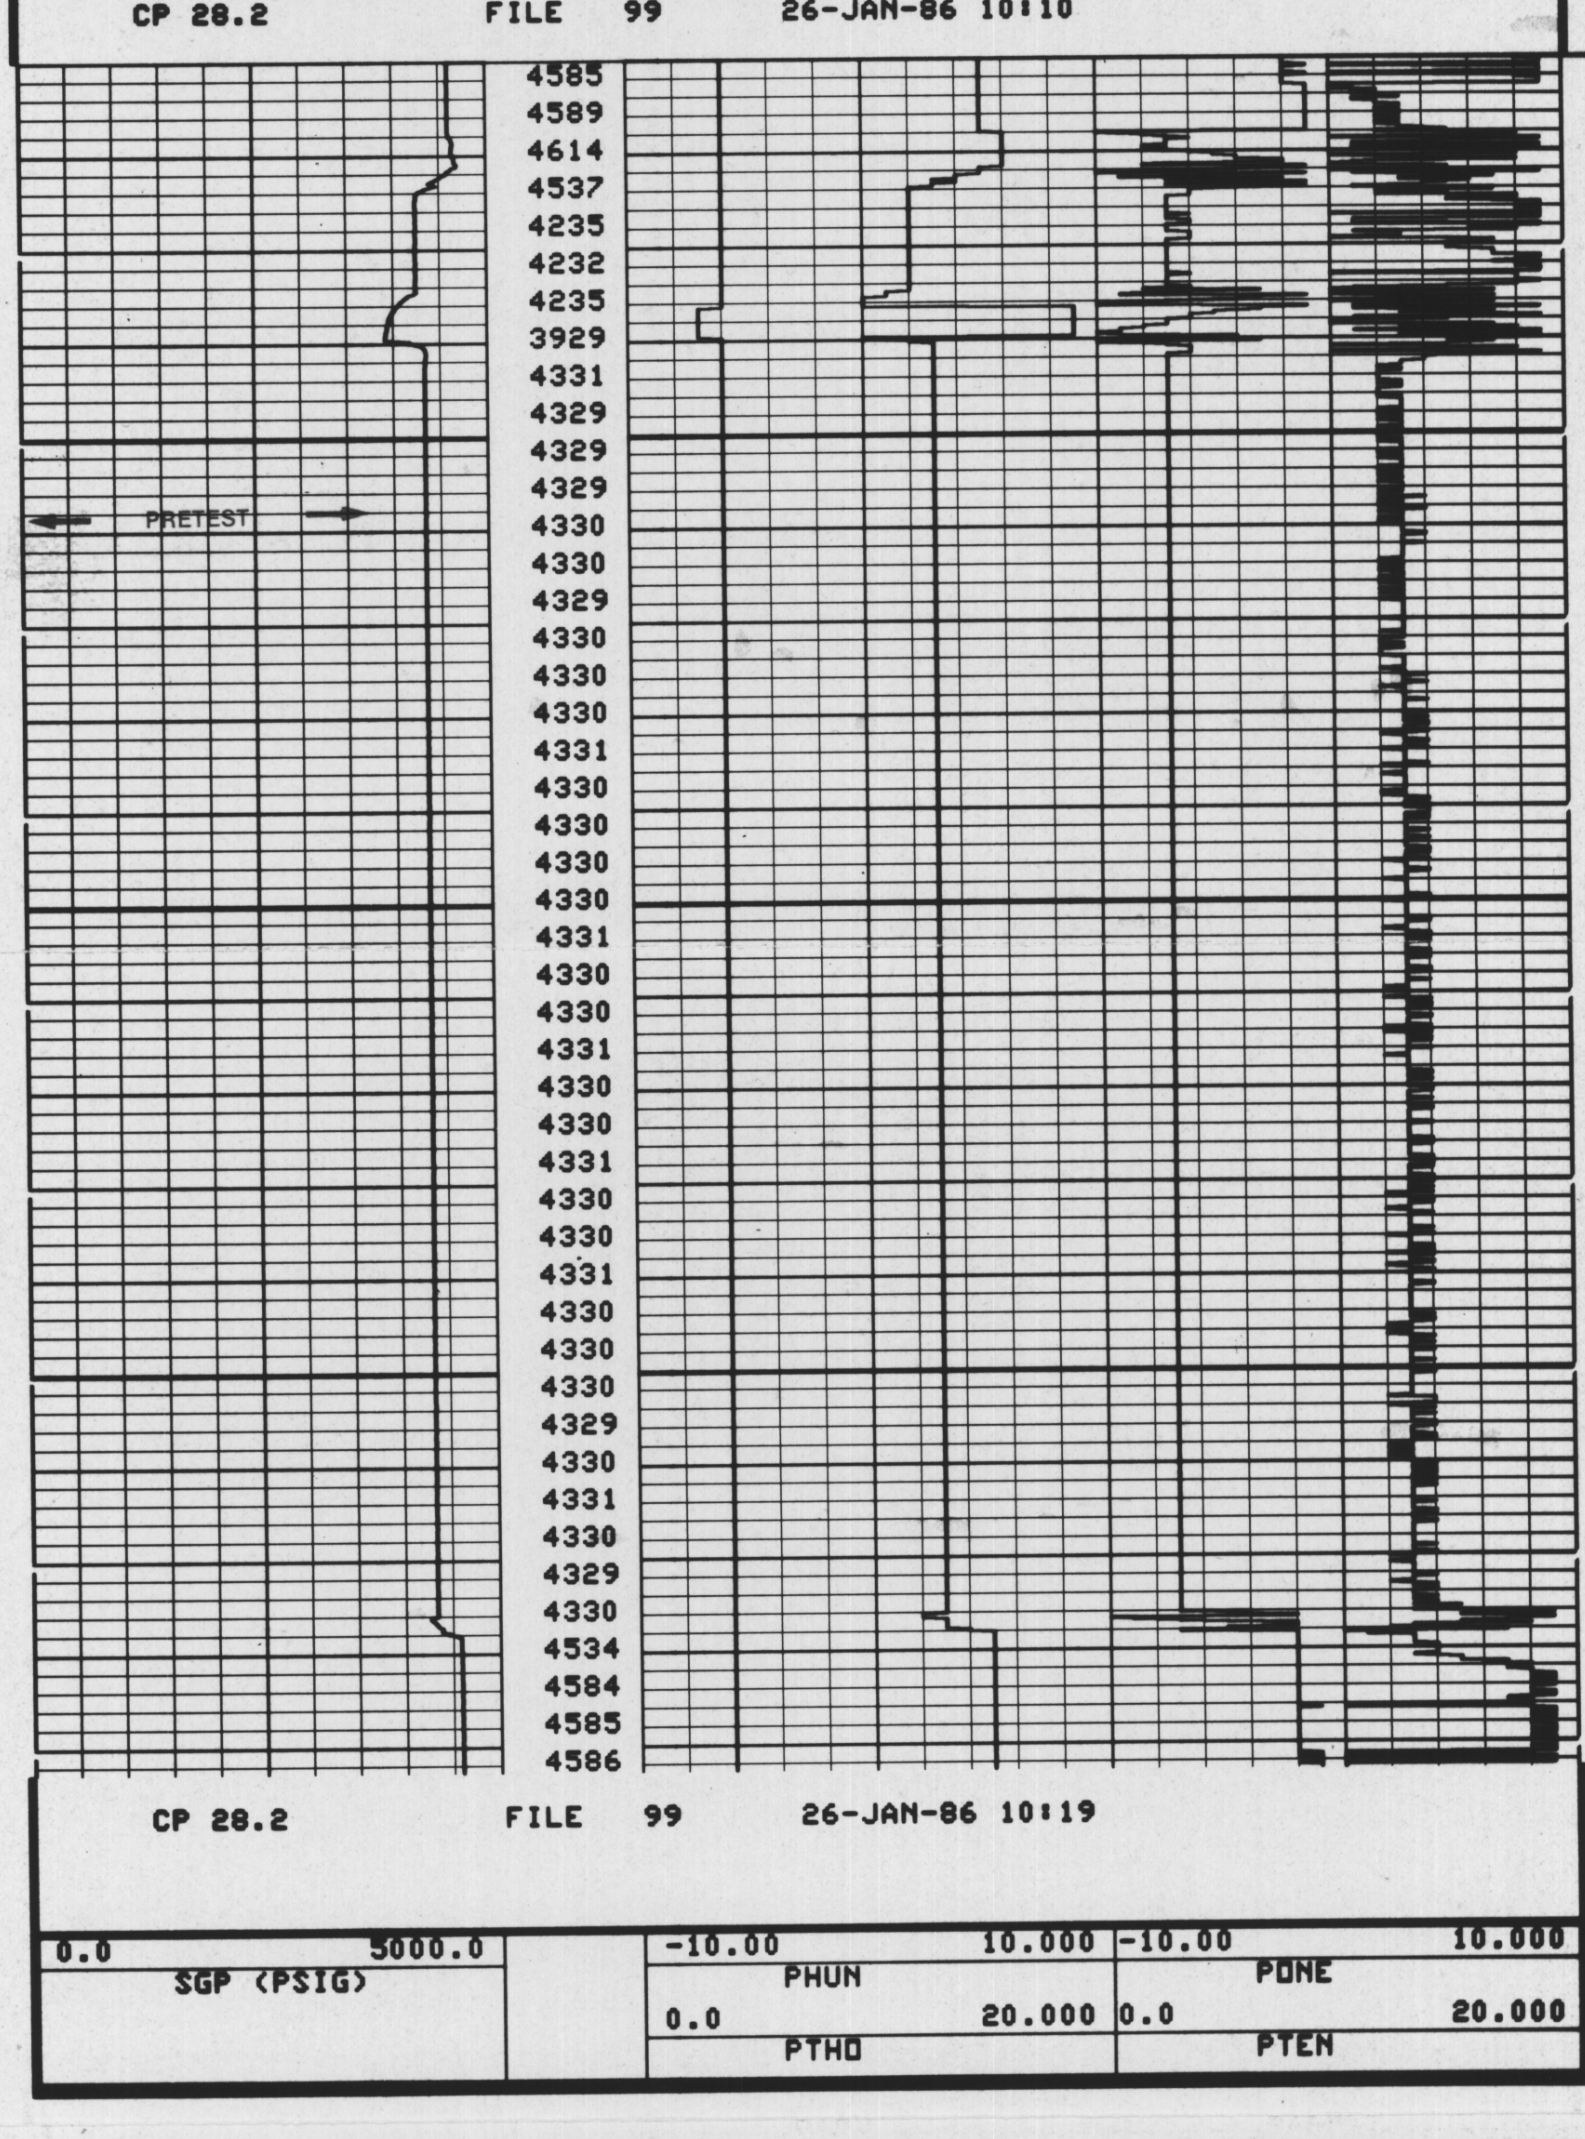

CP 28.2 FILE 99 26-JAN-86 10:19

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	254.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	254.000	DEGF	FDEP	2884.99	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

CP 28.2 FILE 100 26-JAN-86 10:24

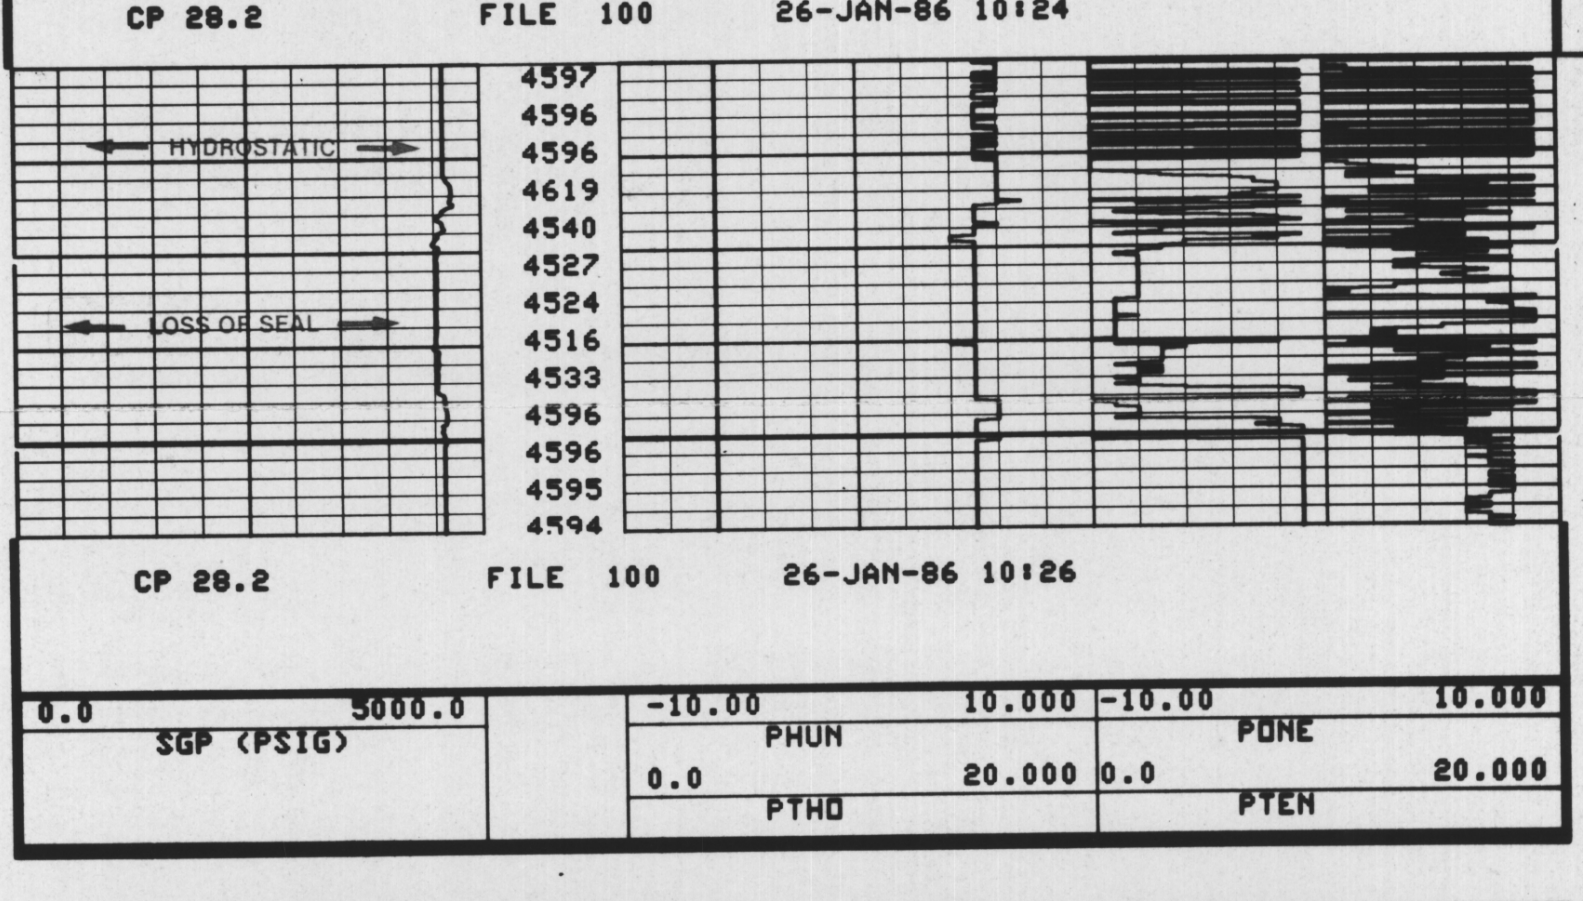

CP 28.2 FILE 100 26-JAN-86 10:26

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	254.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	254.000	DEGF	FDEP	2886.00	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

CP 28.2 FILE 101 26-JAN-86 10:29

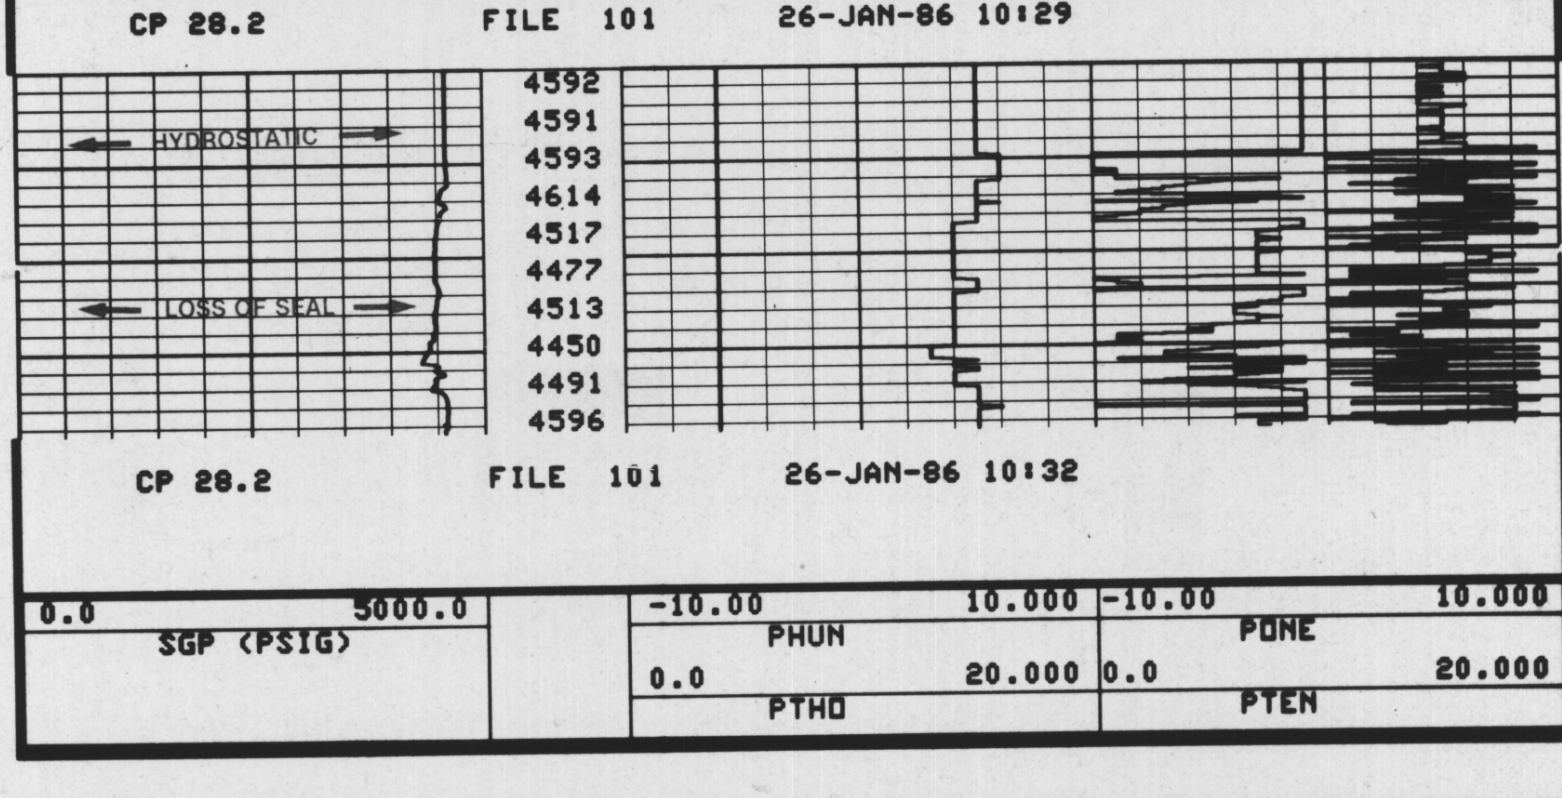

CP 28.2 FILE 101 26-JAN-86 10:32

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	254.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	254.000	DEGF	FDEP	2887.01	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

CP 28.2 FILE 103 26-JAN-86 10:37

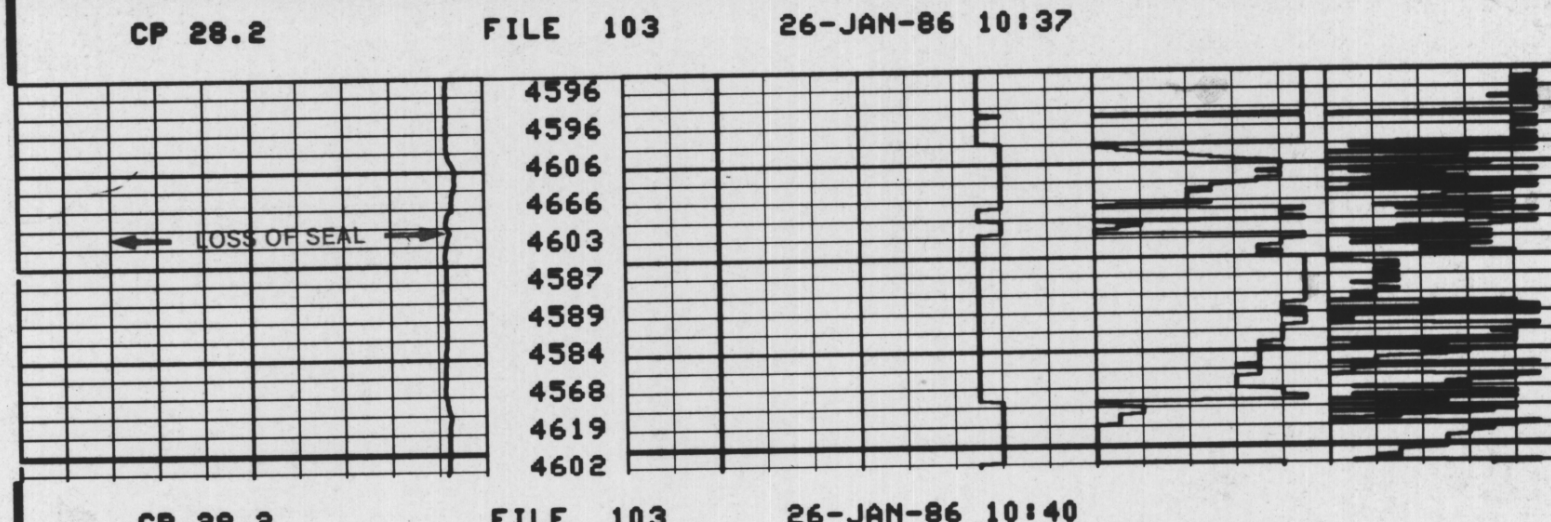

CP 28.2 FILE 103 26-JAN-86 10:40

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	254.500	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	254.500	DEGF	FDEP	2888.04	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

CP 28.2 FILE 104 26-JAN-86 10:46

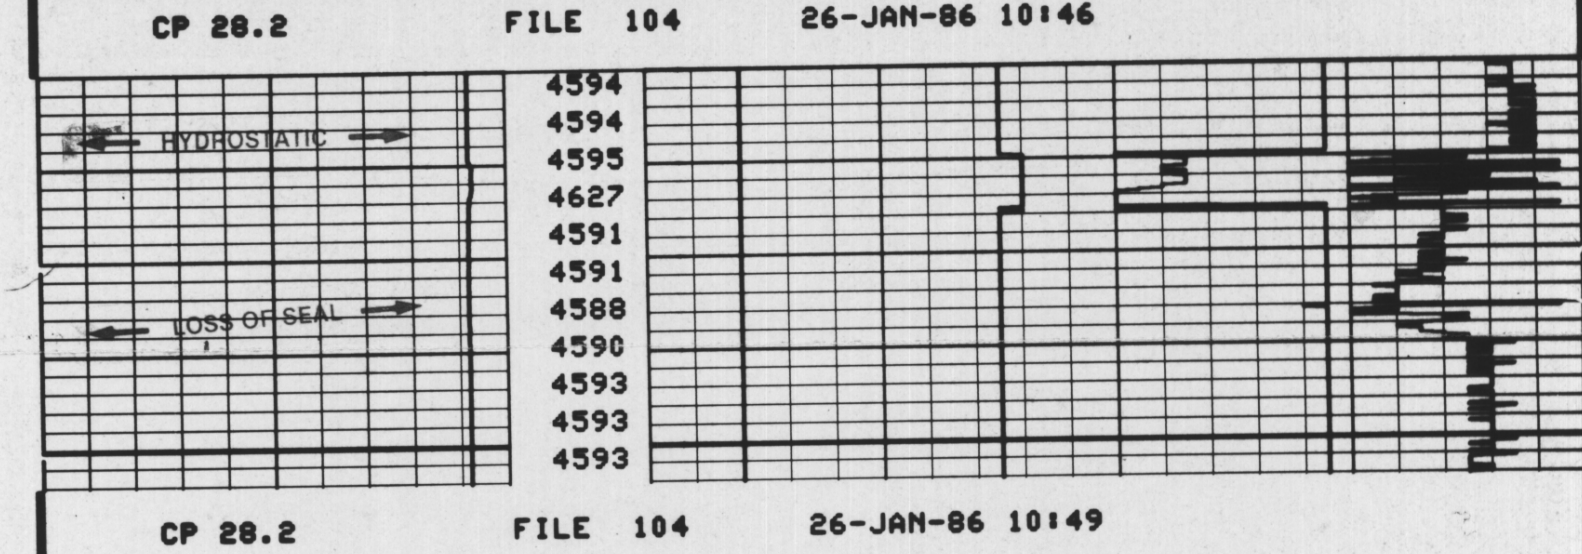

CP 28.2 FILE 104 26-JAN-86 10:49

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	255.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	255.000	DEGF	FDEP	2890.51	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

CP 28.2 FILE 105 26-JAN-86 10:53

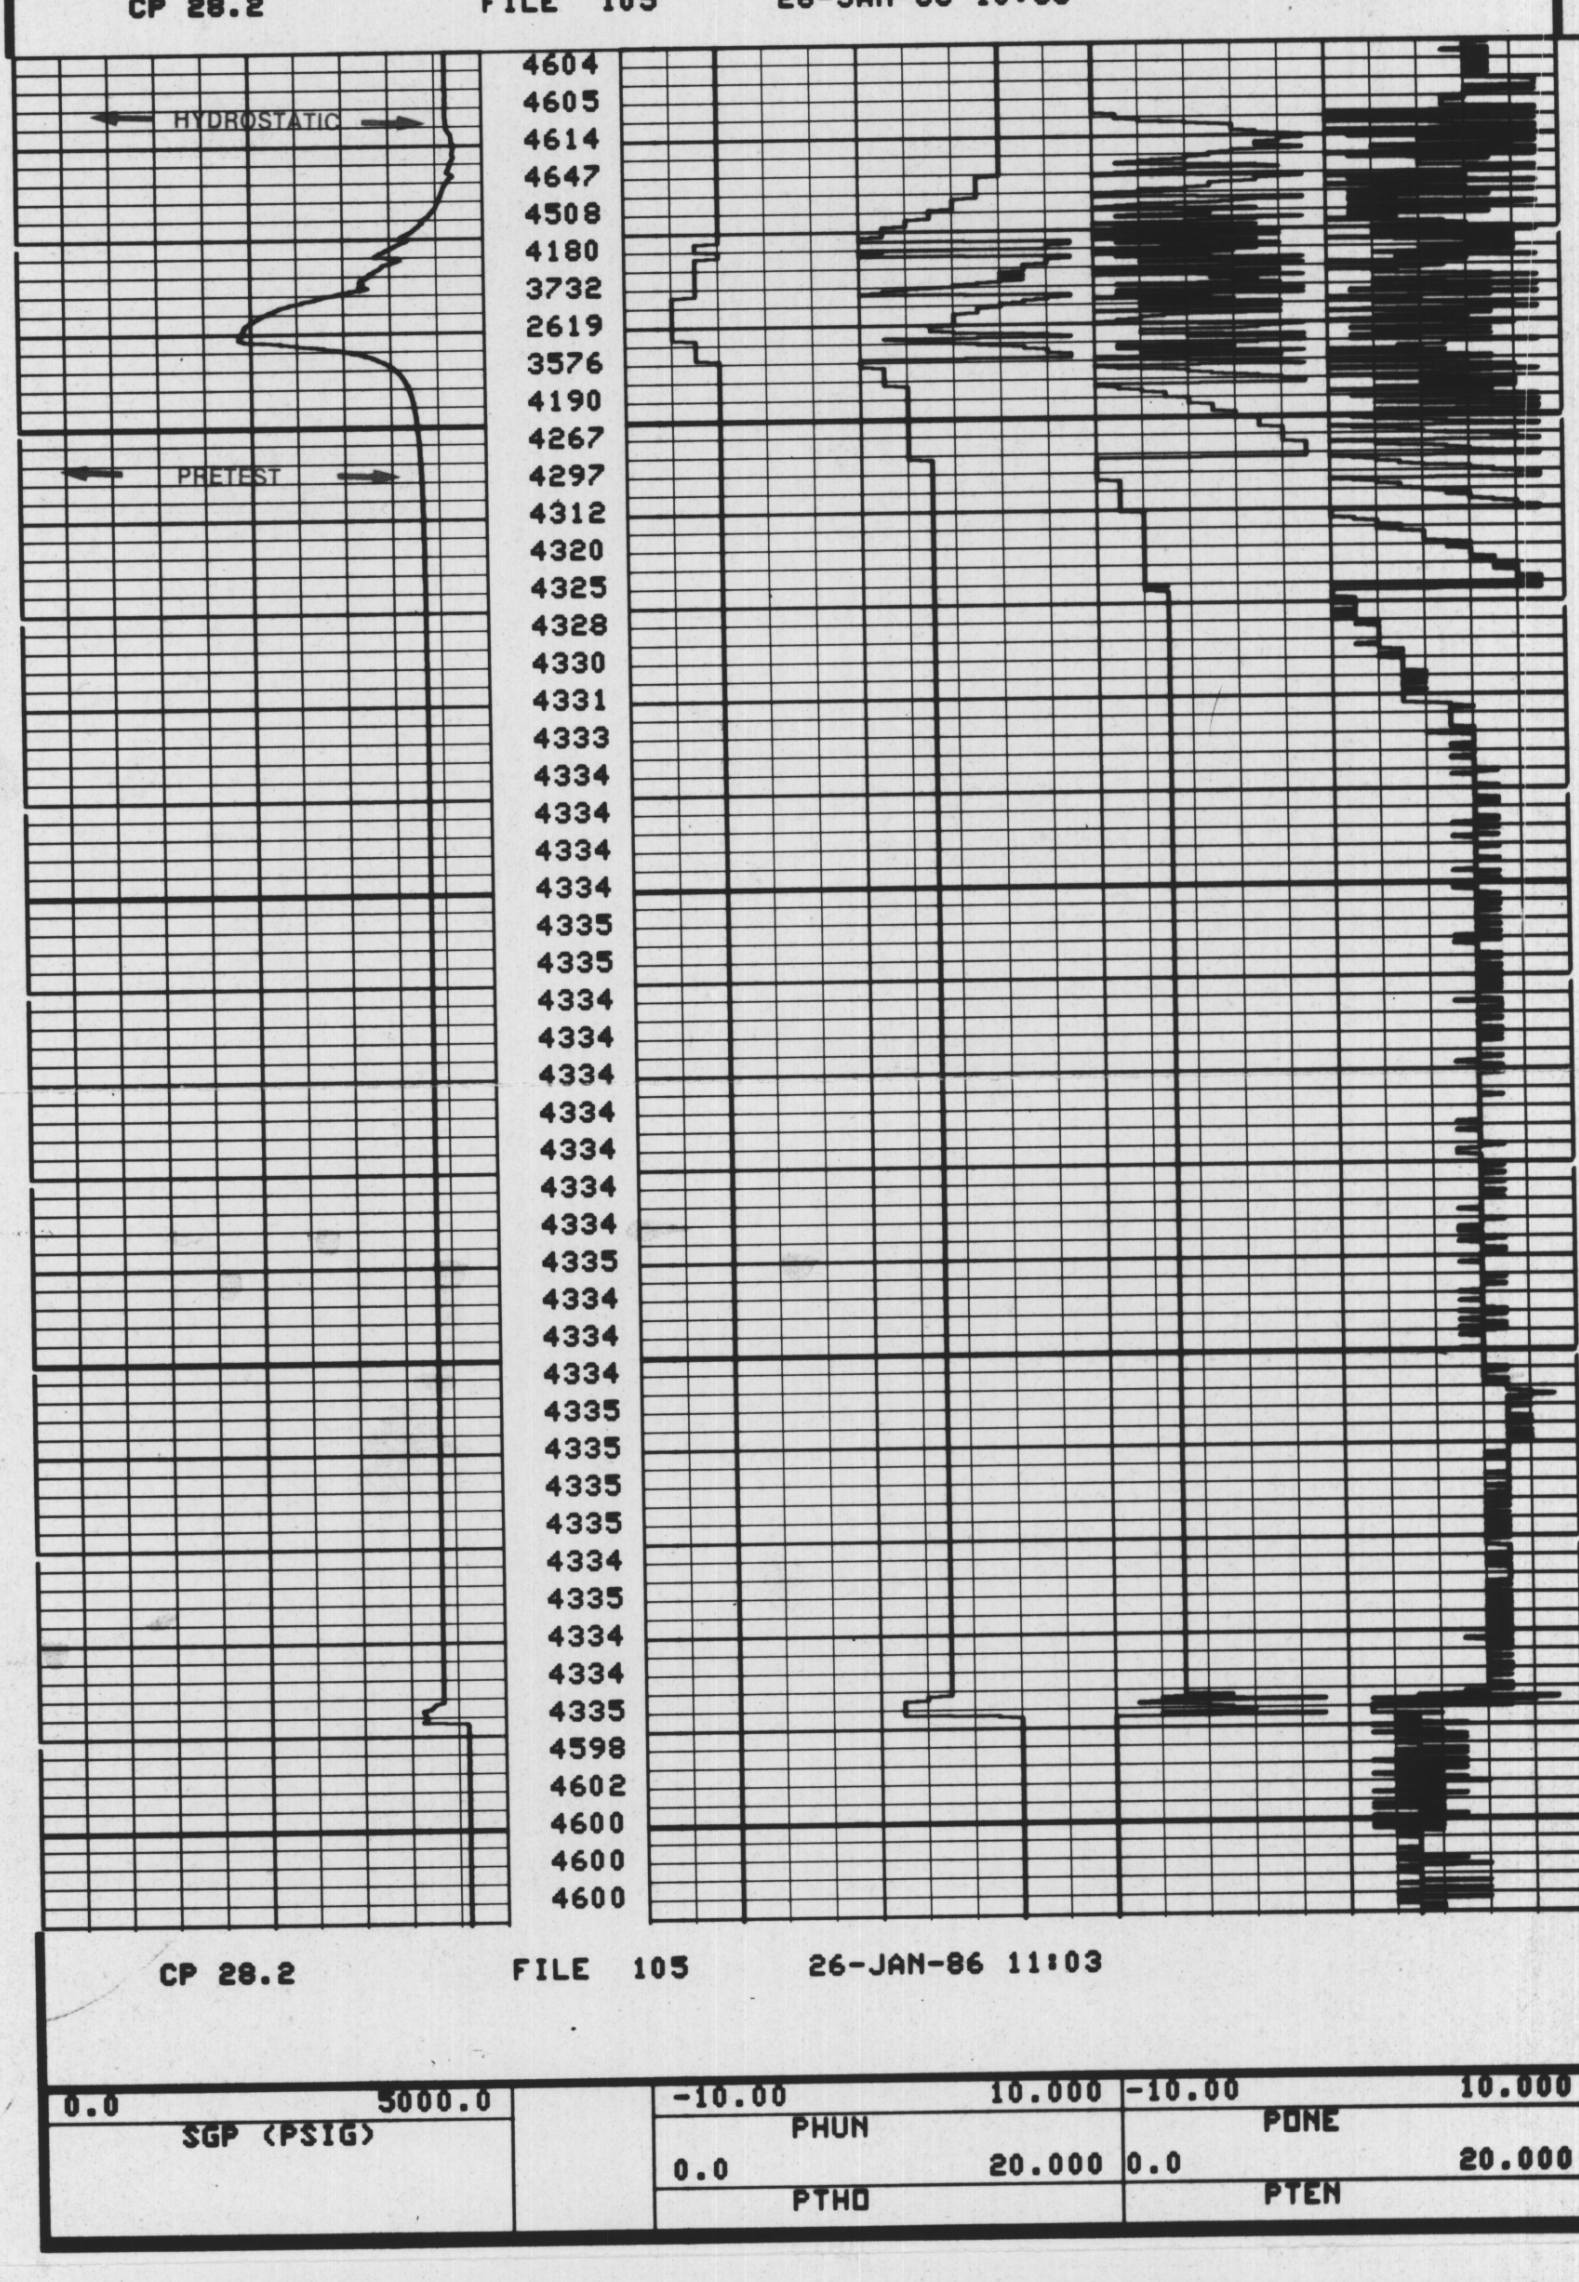

CP 28.2 FILE 105 26-JAN-86 11:03

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	255.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	255.000	DEGF	FDEP	2891.49	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

CP 28.2 FILE 106 26-JAN-86 11:06

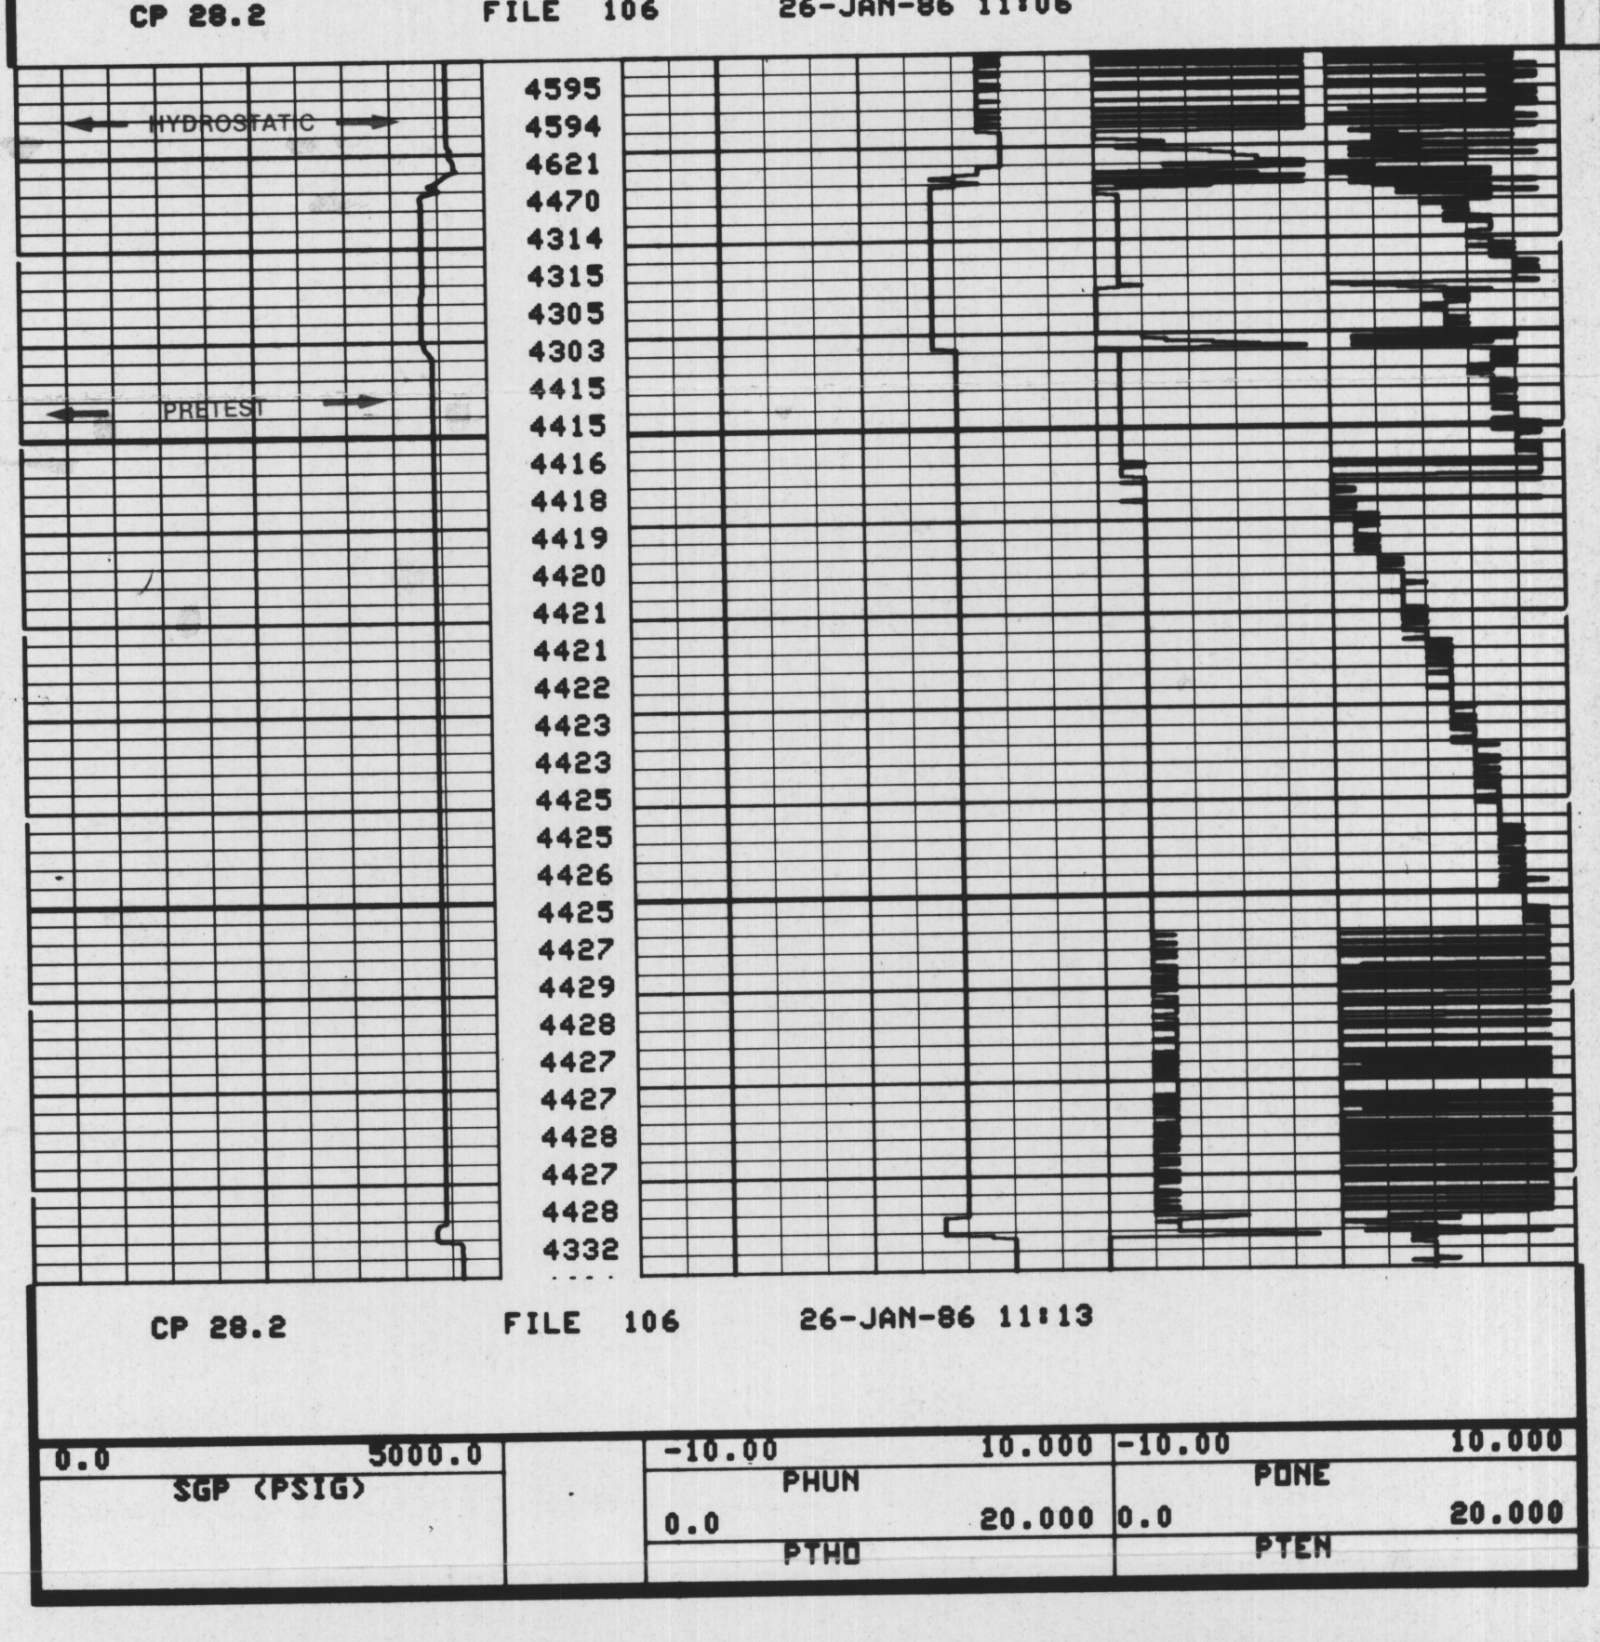

CP 28.2 FILE 106 26-JAN-86 11:13

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	256.500	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	256.500	DEGF	FDEP	2913.98	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

CP 28.2 FILE 107 26-JAN-86 11:22

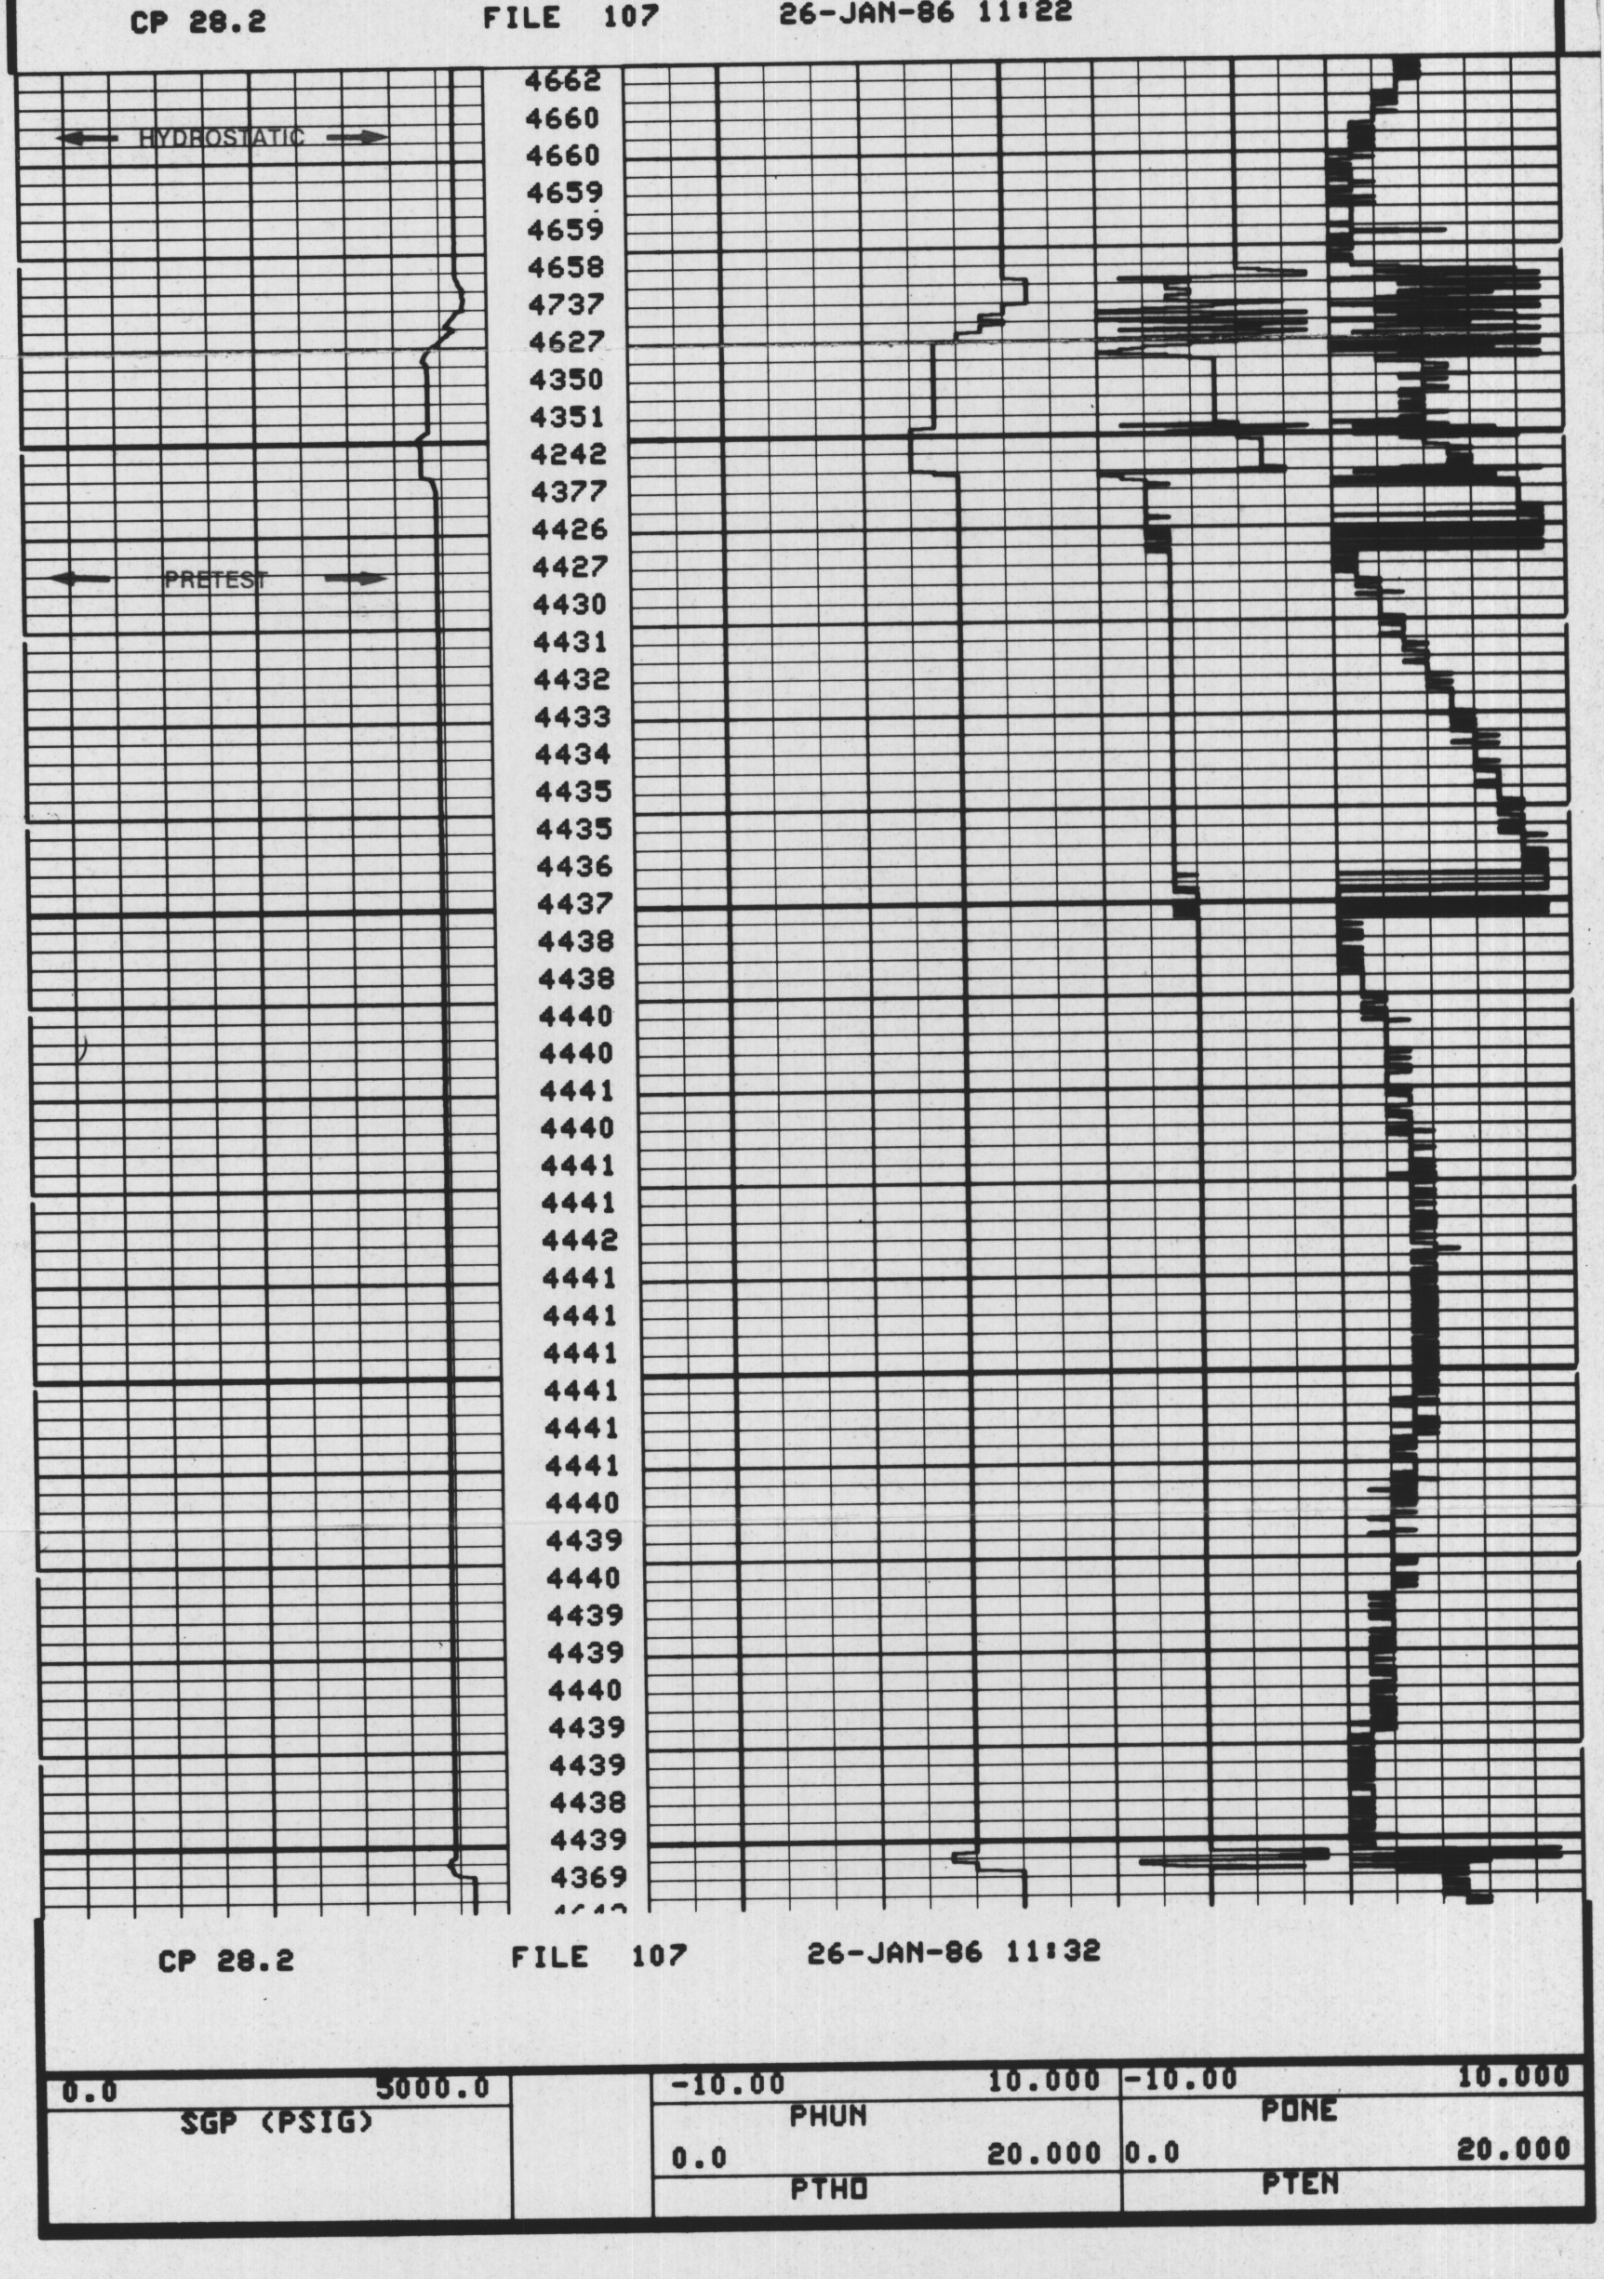

CP 28.2 FILE 107 26-JAN-86 11:32

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	258.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	258.000	DEGF	FDEP	2920.05	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 -10.00 10.000 -10.00 10.000
SGP (PSIG) PHUN PONE
0.0 20.000 0.0 20.000
PTHO PTEN

CP 28.2 FILE 108 26-JAN-86 11:37